


タービュヘイラー 各部位の名称 (薬品名: パルミコート、シムビコート、オーキシス)

“0”が小窓の中央に表示されると 終了



パルミコート

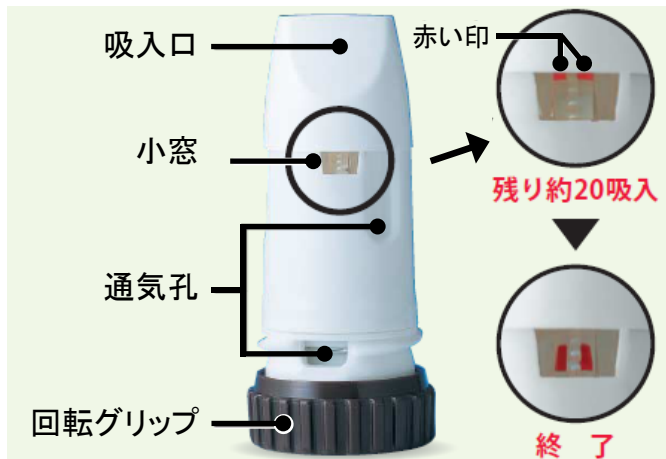

シムビコート、オーキシス

※色・目盛りの数字はそれぞれ異なります

※ 本体を振るとカサカサ音がしますが、薬ではなく乾燥剤の音です

タービュヘイラーの初回準備方法 (薬品名: シムビコート・パルミコート・オーキシス)

※ 新しい吸入器は空打ちを行って下さい

空打ち

- キャップを回して外します
- 吸入器をまっすぐに立て、色つきの回転グリップを左右に回してカチッと3回鳴らします。
(3回目に カチッと鳴らしたところで、止めて下さい)



タービュヘイラーの吸入手順 (薬品名: パルミコート、シムビコート、オーキシス)

- ※ 残量が少ない時は早めに新しいものを処方してもらって下さい
- ※ 初回準備方法(空打ち)は1枚目(1/2)を参照

